

# アルミ袋のノッチ加工部変更のお知らせ

歯科用根管充填シーラ

## キャナルス<sup>®</sup>N 液

(管理医療機器)

2024年10月



株式会社 ジーシー 昭和薬品  
東京都板橋区蓮沼町76番1号


謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、標記製品のアルミ袋のノッチ加工部の変更をいたしますので、ご案内申し上げます。  
しばらくの間、新旧製品が市場に流通いたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  
今後ともなお一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

### 記

#### 変更内容

■ノッチ加工部(片側V型ノッチ→両側ベース型ノッチ)の変更

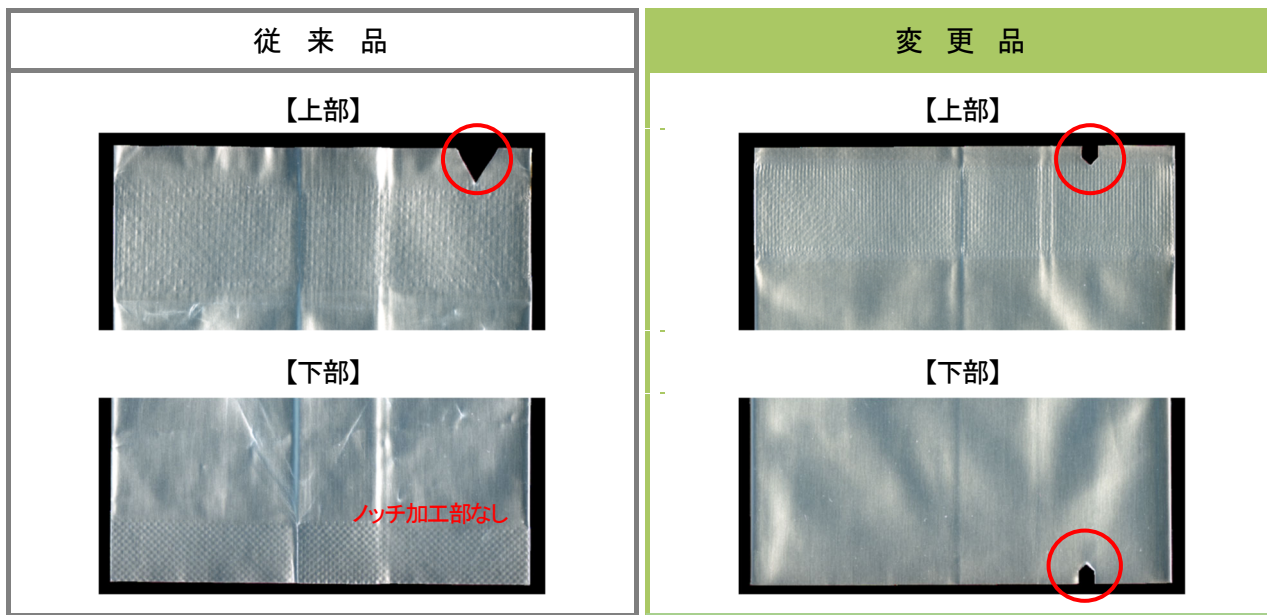

#### 出荷予定時期

販売名	包装	統一商品コード	製造番号		出荷予定時期
			従来品	変更品	
キャナルスN	<セット品> 散 16g、液 10mL	094-887020	~4013L	未定~	2025年10月下旬
	<補充用> 液 10mL	094-887006	~4015LA	4016OA~	2024年11月上旬

※各種コードの変更はございません。

※流通在庫状況により出荷時期に若干の差異が生じることがございますが、ご容赦を賜りますようお願い申し上げます。

以上